

Verso il FSE 2.0


progettualità per il nuovo standard di gestione dei dati sanitari

Ing. Dario Ricci

@ForumRisk   www.forummediterraneosanita.it

28-30 SETTEMBRE 2022
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI

6° Forum
Mediterraneo
2022 in Sanità®

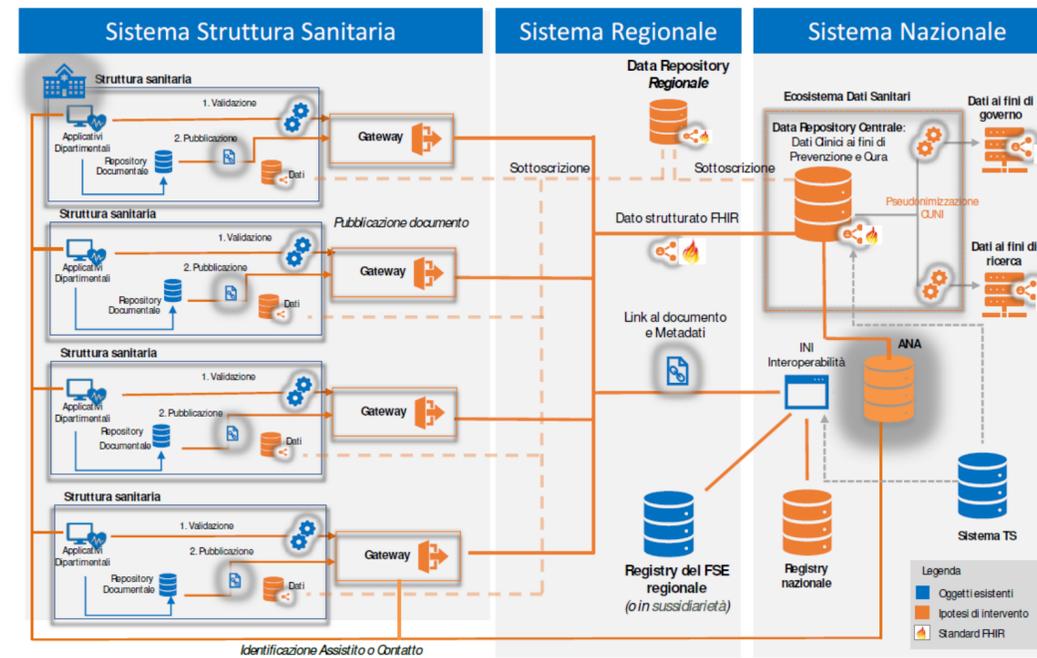


Verso il FSE 2.0

Fonte: GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale n. 160 del 11/07/2022, Allegato A "Linee Guida per l'attuazione del FSE"

@ForumRisk   www.forummediterraneosanita.it

28-30 SETTEMBRE 2022
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI

6° Forum
Mediterraneo
2022 in Sanità®

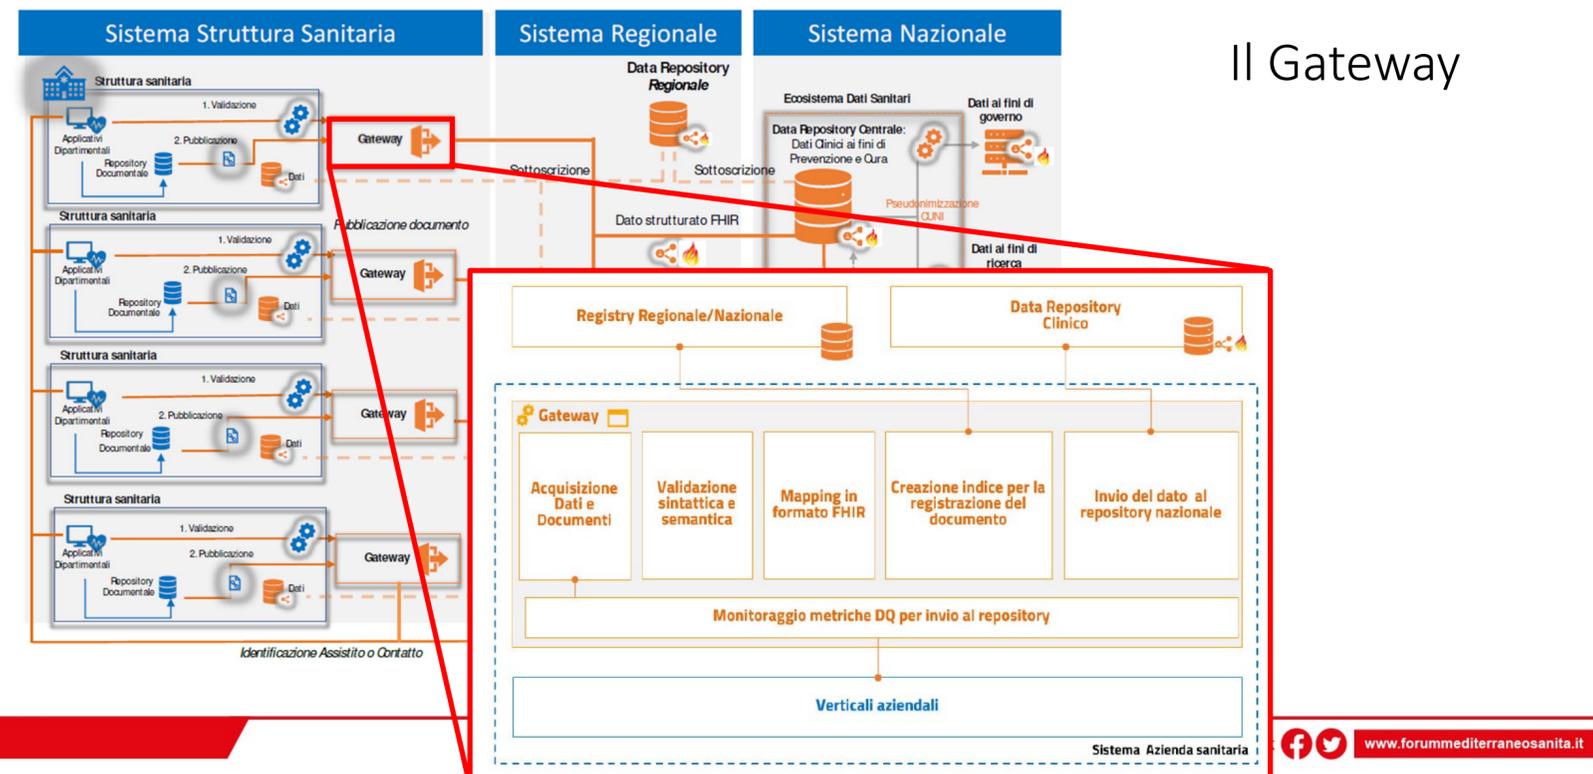

28-30 SETTEMBRE 2022
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI

6° Forum
Mediterraneo
2022 in Sanità®

28-30 SETTEMBRE 2022
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI

6° Forum
Mediterraneo
2022 in Sanità®




2 progetti




@ForumRisk   www.forummediterraneosanita.it

Progetto 1: Predisposizione del Repository in funzione del Gateway

Il progetto tecnico

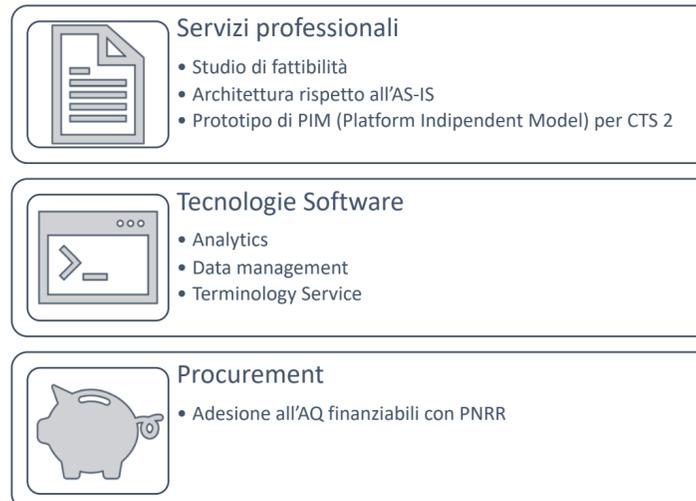

I temi aperti

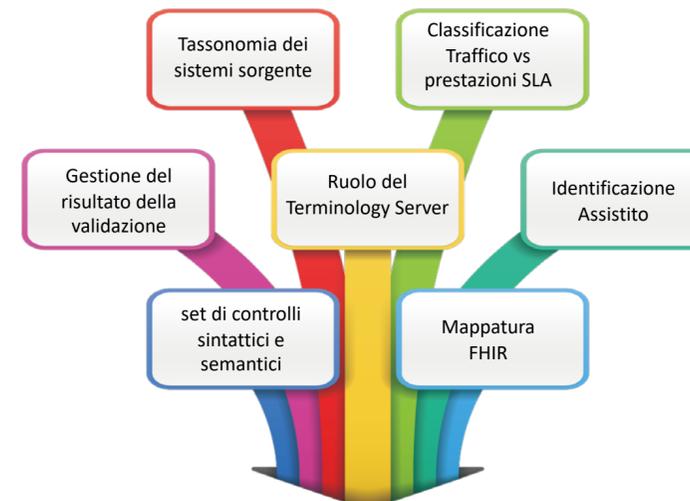


Progetto 2: Potenziamento adoption clinica SIO

Qualità dei dati preliminari




Il progetto organizzativo


1. Migrazione anagrafica e creazione MPI
2. Formazione per miglioramento adoption clinica
3. Attivazione documentazione clinica specialistica
4. Attivazione Farmacoterapia

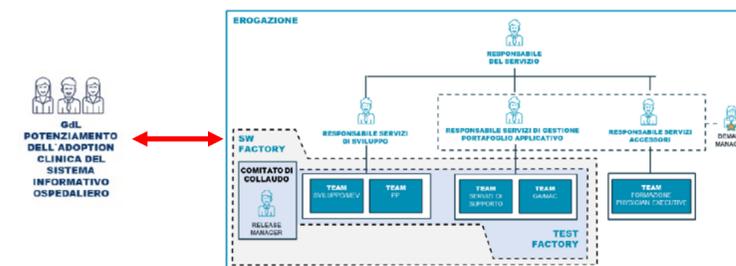

Il paziente al centro: interoperabilità

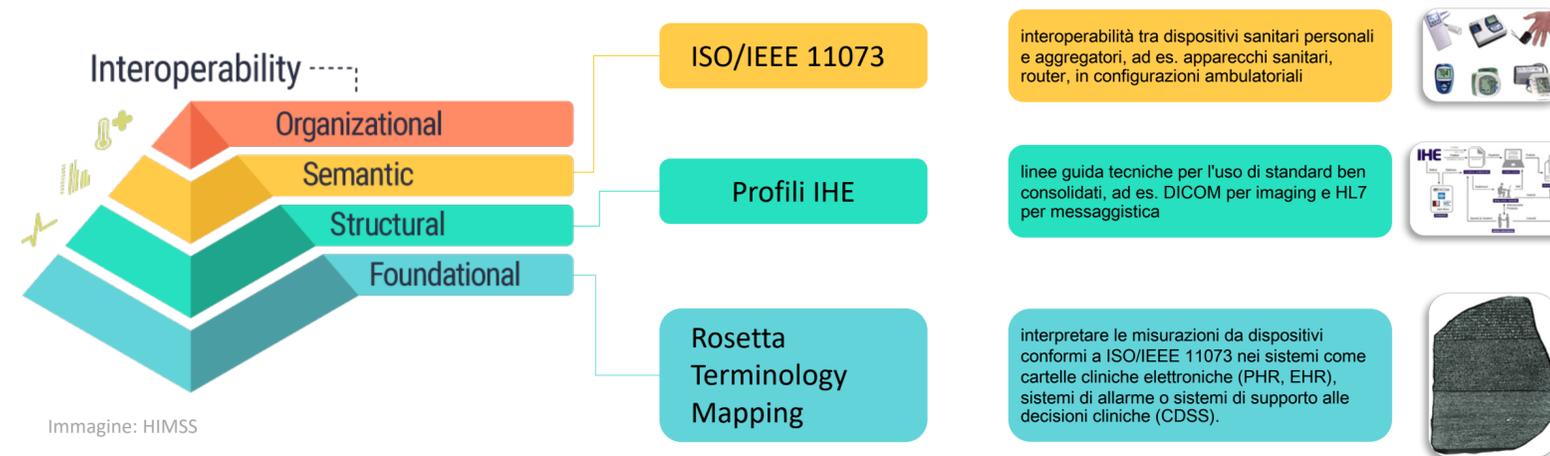

Il paziente al centro: interoperabilità

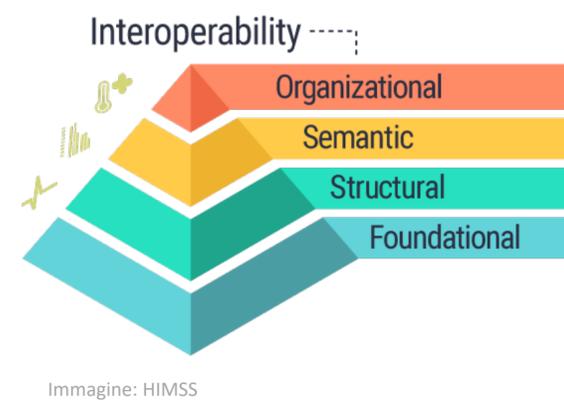

ISO/IEEE 11073

| Personal Health Device (PHD) - Percentage | Covered by IEEE-WG for PHDs | Reference |
|---|-----------------------------|--|
| pulse oximeter - (43%) | ✓ | [21], [27], [29], [32], [38], [39], [40], [46], [47], [51], [52], [53], [57], [62], [82], [86], [87], [89], [91], [92], [94], [95], [96] |
| blood pressure monitor - (34%) | ✓ | [22], [23], [30], [38], [40], [45], [46], [53], [54], [55], [60], [71], [86], [87], [91], [92], [93], [94] |
| weighting scale - (30%) | ✓ | [22], [23], [29], [30], [38], [40], [46], [53], [61], [87], [89], [91], [92], [93], [94], [95] |
| blood glucose meter - (25%) | ✓ | [22], [30], [33], [38], [40], [54], [60], [71], [84], [85], [86], [91], [93] |
| electrocardiograph (ECG) - (23%) | ✓ | [23], [29], [47], [51], [54], [56], [57], [79], [80], [81], [82] |
| smart phone camera and sensors - (13%) | ✓ | [2], [33], [51], [58], [90], [94], [99] |
| Thermometer - (6%) | ✓ | [55], [86], [96] |
| physical activity monitors - (4%) | ✓ | [23], [72] |
| medication dispensers - (4%) | ✓ | [91], [95] |
| bed sensors - (4%) | ✓ | [91], [95] |
| Wii Balance Board - (2%) | ✓ | [24] |
| fall detection sensor - (2%) | ✓ | [58] |
| pedometer - (2%) | ✓ | [54] |
| independent living activity hub - (2%) | ✓ | [56] |
| Plethysmogram (PPG) - (2%) | ✓ | [86] |
| chair sensors - (2%) | ✓ | [91] |
| smart shoe insole - (2%) | ✓ | [97] |
| iPad system - (2%) | ✓ | [30] |



H. F. Badawi et al.: ISO/IEEE 11073 X73-PHD Standards Compliant Systems

@ForumRisk



www.forummediterraneosanita.it



28-30 SETTEMBRE 2022
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI

6° Forum
Mediterraneo
2022 in Sanità®




Fonte: Marzio Bartoloni: «Sanità, le sette emergenze dimenticate», Sole 24 Ore, domenica 4 settembre 2022




@ForumRisk www.forummediterraneosanita.it

28-30 SETTEMBRE 2022
BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI

6° Forum
Mediterraneo
2022 in Sanità®

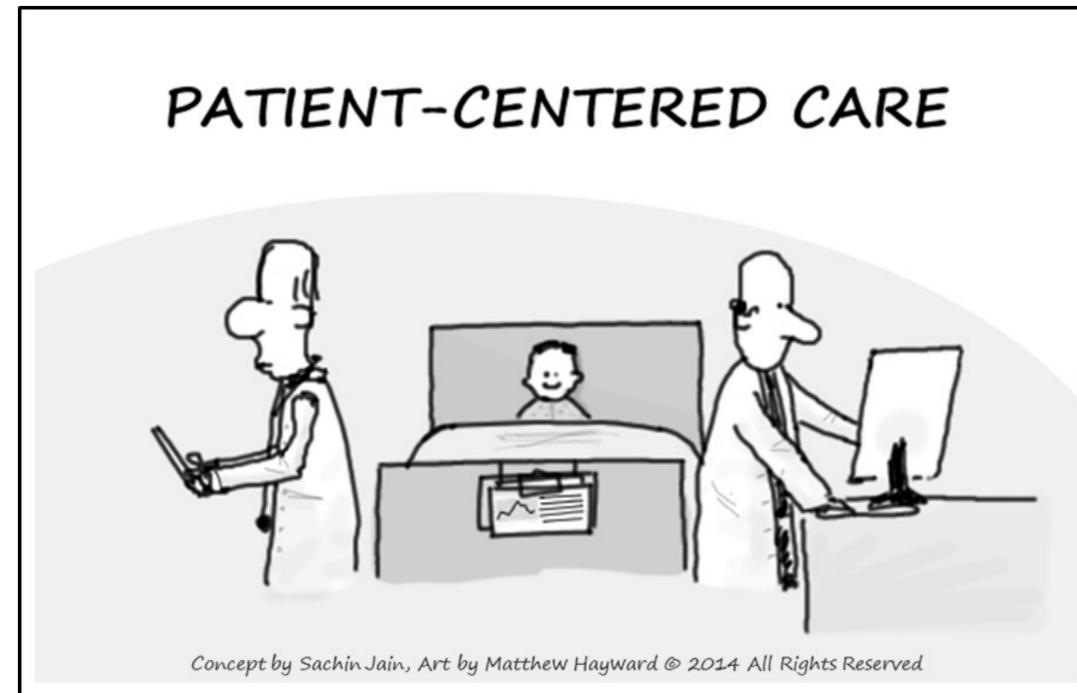

@ForumRisk   www.forummediterraneosanita.it

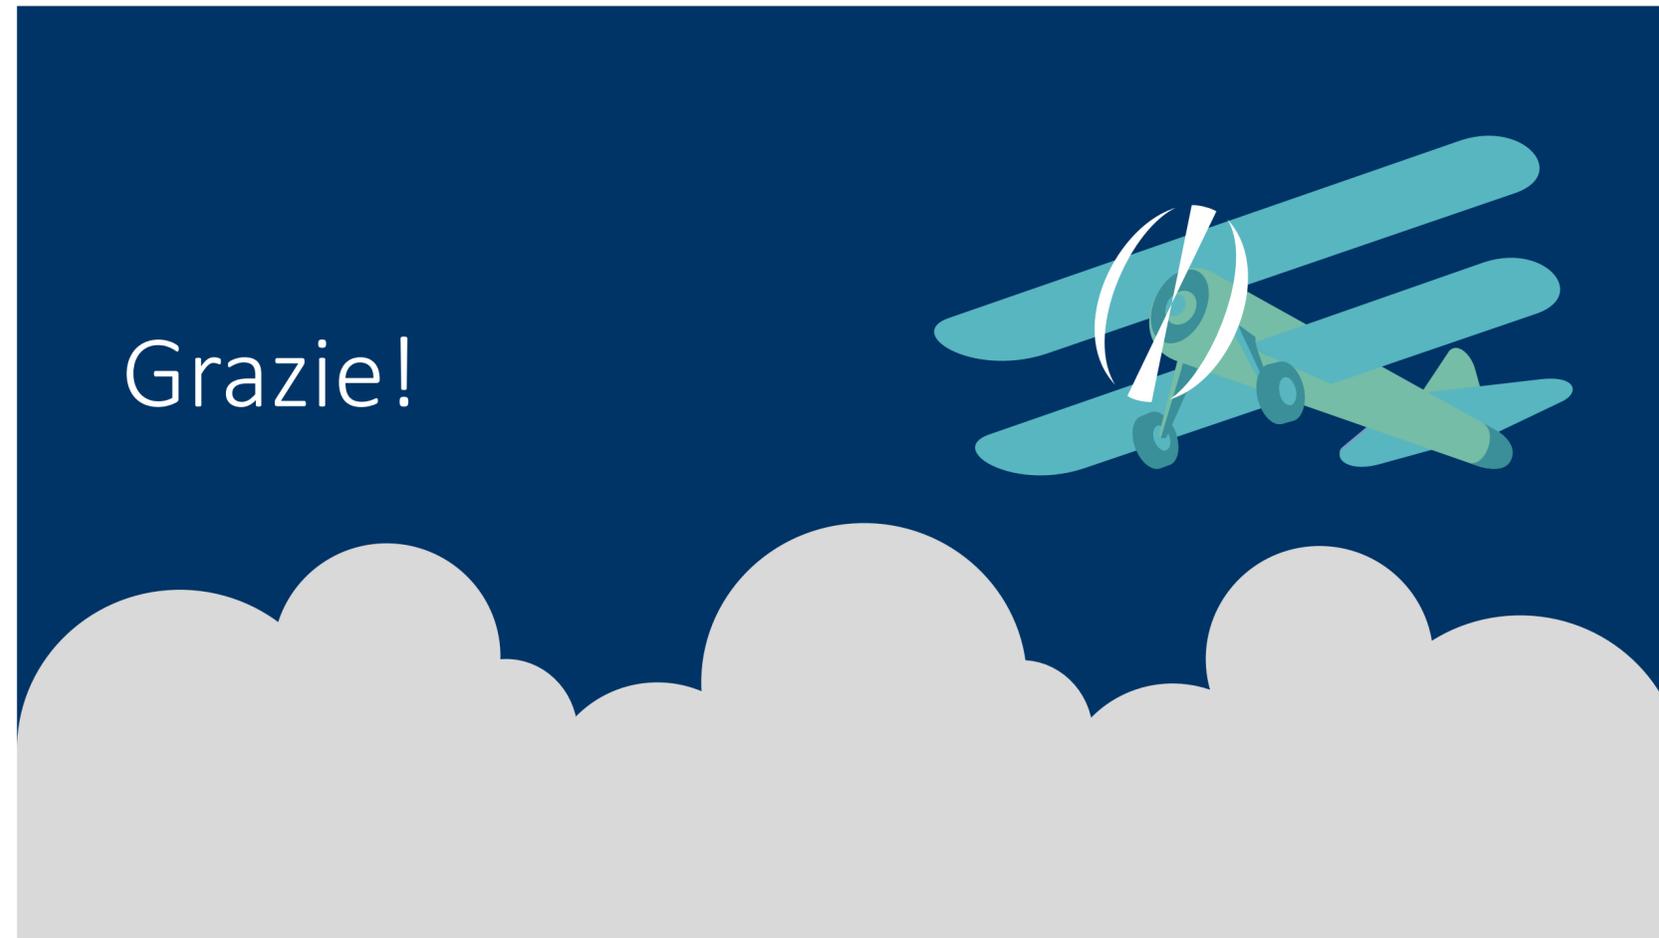

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

[Torna all'inizio](#)